引き開け式（テープ封緘）の個装ケース

未開封の確認方法 及び 適切な開封方法のご案内

謹啓　時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は、弊社製品につきまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて このたび引き開け式（テープ封緘）個装ケースについて、未開封の確認方法 及び
適切な開封方法をご案内いたします。ご不明な点などございましたら、下記までお問い合わせください。

謹白

アステラス製薬株式会社

記

未開封の確認方法

未開封（個装ケース）の状態

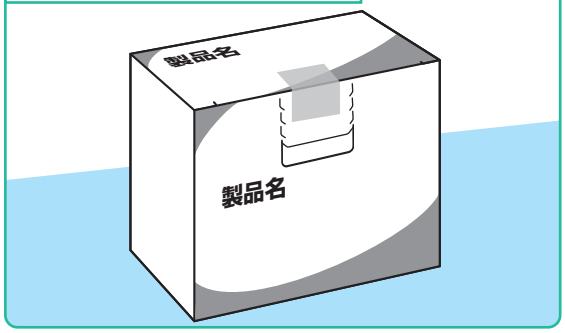

ケースについて次の事項を確認してください。注

- □ミシン目が切れていないこと
- □封緘テープがしっかりと貼付されていること
- □ケース全体に不自然な破れが無いこと

注）実際の封緘テープは柄があります。
注）ケースの形状は製品によって異なります。

例）

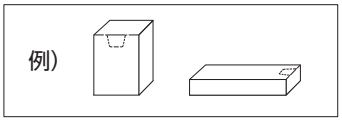

適切な開封方法

1 開封方法

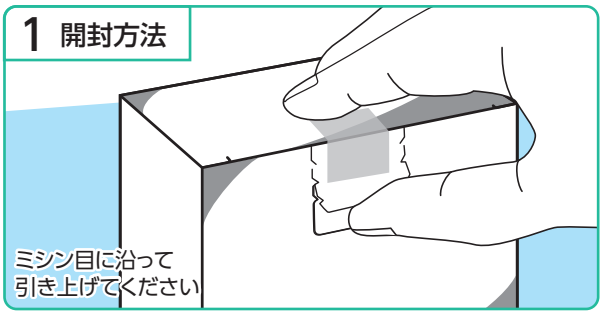

2 開封後の状態

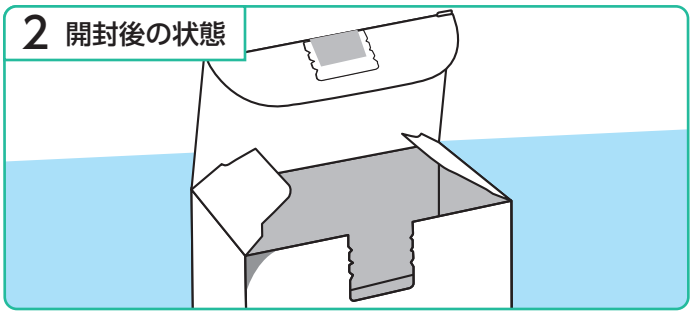

⚠ 以下の場合はすでに開封されている可能性があります。

ミシン目が切れている

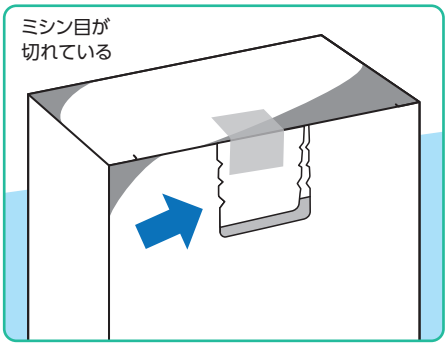

封緘テープが切れている

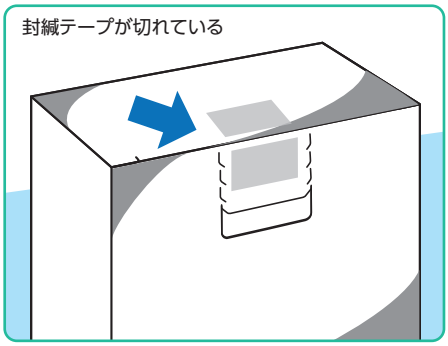

封緘テープをはがしたあとがある

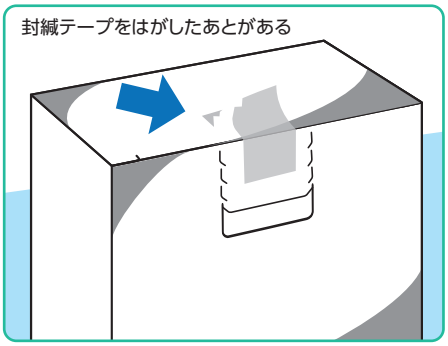

※ご購入時に開封されている可能性がある場合は、開封される前に弊社担当MRまたは、下記お問い合せまでご連絡下さい。

アステラス製薬株式会社 メディカルインフォメーションセンター
フリーダイヤル 0120-189-371／受付時間 月～金 9：00～17：30（土日・祝日・会社休日を除く）

Kyt19117A01
2020年9月発行